

Dipartimento Laboratori di prova

Presentazione RT-23 rev. 05

Roma
Roma 22-06-2026



1

Presentazione RT-23 rev. 05

Ilenia Siciliano, Lorenzo Signorini, Giulia Casati, M. Pina La Penna

Funzionari Tecnici, Ispettori Tecnici
ACCREDIA



2

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Materiale/Prodotto/Matrice

Nel campo "Materiale/Prodotto/Matrice" viene riportato quanto previsto nel campo di applicazione del metodo.

Matrici non previste ma assimilabili con l'1)

Acque destinate al consumo umano | Acque di scarico | Acque minerali naturali (1) | Acque naturali | Rifiuti liquidi acquosi (1) |

verifica preliminare delle performance (LOQ, LOD, recuperi, incertezza, Interferenti...)

1 Scope

This International Standard specifies a method for the determination of dissolved elements, elements bound to particles ("particulate") and total content of elements in different types of water (e.g. ground, surface, raw, potable and waste water) for the following elements: aluminium, antimony, arsenic, barium, beryllium, bismuth, boron, cadmium, calcium, chromium, cobalt, copper, gallium, indium, iron, lead, lithium, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, phosphorus, potassium, selenium, silicon, silver, sodium, strontium, sulfur, tin, titanium, tungsten, vanadium, zinc and zirconium.

1 Scope

This part of ISO 9963 specifies a method for the titrimetric determination of alkalinity. It is intended for the analysis of natural and treated water, and waste water, and can be used directly for waters having an alkalinity concentration of up to 20 mmol/l. For samples containing higher concentrations of alkalinity, a smaller test portion can be used for analysis. The recommended lower limit is 0,4 mmol/l. Suspended matter in the form of carbonate may interfere with the analysis. This interference can be reduced by filtration prior to the titration.

The endpoint detection, using a pH-meter, is less prone to interferences than the use of the indicator.

ACCREDIA

Webinar 22 giugno 2026

3

3

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Materiale/Prodotto/Matrice

Il laboratorio, in alcuni casi, può **limitare** l'applicazione di un metodo a sole specifiche Matrici/prodotti (es solo latte) ma non può generalizzare (es apparecchiature elettriche a fronte di un campo di applicazione «Frullatori»).

Alimenti/Food - escluso/except Latte crudo/Raw milk, Bevande/Beverages			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Bacillus cereus/Bacillus cereus	AOAC TEMPO BC n 071401 2014	Tempo-MPN	

Nel caso in cui uno stesso metodo sia applicabile a matrici afferenti a diversa macromatrice, in Atlante sono presenti righe diverse.

Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque meteoriche/Rain waters, Acque superficiali/Surface waters, Effluenti/Effluents, Percolati/Leachates			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (50 - 1500 keV)	UNI 11665:2023	Spettrometria gamma	

Cementi/Cements, Ceneri/Ashes, Fanghi/Sludges, Grafite/Graphite, Incrostazioni/ Encrustations, Materiali metallici/Metallic materials, Particolato depositato su filtri/Particulate as deposited on filters, Polveri/Powders, Prodotti da costruzione/Construction products, Resine/Resins, Scorie/Dross, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (50 - 1500 keV)	UNI 11665:2023	Spettrometria gamma	

ACCREDIA

4

4

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della Prova

Alcuni metodi di prova indicano esplicitamente la possibilità di **ampliare** lo scopo per la determinazione di ulteriori parametri non previsti: solo per questi casi, i Laboratori possono richiedere ad ACCREDIA di inserire in Atlante i parametri aggiuntivi, purché gli stessi rientrino nell'ambito previsto dal metodo (vedere

Regolamento ACCREDIA RT-08 par 7.2.1.1).

Si ricorda che alcuni metodi indicano la possibilità di ampliarne l'impiego per la determinazione di ulteriori parametri non previsti; il Laboratorio può aggiungerli previa validazione degli stessi.

Ad esempio: è possibile, per il metodo UNI EN 15662, aggiungere altri pesticidi ma non IPA o PCB

ACCREDIA

5

5

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della Prova

Al fine di raggruppare **alcune specifiche classi** di composti e per facilitare le ricerche nel database è stato inserito un campo denominato "Gruppo".

Ad esempio: "Pesticidi: Alfametrina, Azinfos-Etile, Azinfos-Metile, Benalaxil, Bromofos-Etile, Captafol, Captano, Carbensulfam"

Nel caso in cui uno stesso metodo sia applicabile a "Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della prova" afferenti a diversi gruppi, in Atlante sono presenti righe diverse

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	Obi
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	GC-MS	
Pesticidi/Pesticides: Alachlor/Alachlor, Aldrin/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alpha-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Ametrina/Ametryne, Atrazina/Atrazine, Azinfos-etile/Azinphos-ethyl, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Benalaxil/Benalaxil, Benturalin/Benturalin, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Bromofos-etile/Bromophos-ethyl, Bromofos-metile/Bromophos-methyl, Bromopropilato/Bromopropylate, Carbosulfam/Carbophenothion, Cianazina/Cyanazine, Clordano (Cis + Trans)/Chlordane (Cis + Trans), Clorfenossolo/Chlorfenson, Clorfenossolo/Chlorfenvinphos, Clorotalonil/Chlorothalonil, Clorpirifos metile/Chlorpyrifos methyl, Clorpirifos/Chlorpyrifos, Diazinone/Diazinon, Dieldrina/Dieldrin, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endosulfan sulfato/Endosulfan sulfate, Ectossolo/Ectosol, Ectossolo-acossolo/Endosulfan			

ACCREDIA

6

6

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione

Prova da calcolo

- 1) parametri derivanti da calcoli descritti all'interno del metodo unitamente alla determinazione di tutti i parametri coinvolti nel calcolo (es. Umidità e Residuo secco con UNI EN 12880....). In tal caso, in Atlante, sono censiti tra i parametri senza l'indicazione del termine "da calcolo".

Es AOAC 992.23 per azoto totale
con calcolo per Proteine

F. Calculations

For wheat and its products:

$$\text{Crude protein, \%} = N \times 5.70$$

For other cereal grains and oilseeds:

$$\text{Crude protein, \%} = N \times 6.25$$

ACCREDIA

7

7

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della Prova da calcolo

- 2) parametri derivanti da calcoli non descritti all'interno di un metodo, ma derivanti da calcoli semplici, trasparenti e universalmente accettati.

In tale caso, tali parametri non sono riportati in Atlante, né il laboratorio deve richiederli esplicitamente in accreditamento, in quanto lo stato di accreditamento è chiaramente rappresentato dalle prove i cui risultati rientrano nel calcolo.

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, le somme di quantità di sostanza (ad esempio somma di pesticidi, somma di PFAS, trialometani totali, acidi grassi, micotossine), **i calcoli stechiometrici ben definiti (es da Silicio → Silice, Nichel → Solfato di Nichel) e i rapporti tra parametri** la cui denominazione chiarisce inequivocabilmente l'origine e il calcolo (ad esempio rapporto carbonio/azoto, grasso/residuo secco, umidità/proteine, sale/sostanza secca).

ACCREDIA

8

8

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della Prova da calcolo

3) parametri derivanti da calcoli, **non** rientranti nelle due precedenti casistiche, come:

- non riconducibili a formule semplici, univoche o universalmente riconosciute,
- per i quali la letteratura prevede differenti modalità di calcolo, tali da generare incertezza sull'origine del risultato,
- per i quali sia necessario evidenziare esplicitamente il parametro che, con il calcolo, cambia denominazione e la stessa non è direttamente riconducibile al/ai parametro/i da cui deriva il calcolo (es. valore energetico, estratto non riduttore, numero di uova).

In questo caso le prove sono censite in Atlante

Pasta all'uovo/Egg pasta			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Estratto etero/Ethereal extract	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39	Gravimetria	
Numero di uova/Amount of eggs, Steroli/Sterols	DM 23/07/1994 SO 4 GU n 186 10/08/1994 Ali pag 18	Gravimetria	

ACCREDIA

9

9

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della Prova da calcolo

Per alcuni specifici casi possono essere inseriti in Atlante i parametri associandoli al documento che contiene i calcoli come norme autonome. In questi casi il laboratorio deve selezionare sia il riferimento del calcolo che tutte le norme di prova relative ai test che sono coinvolti nel calcolo

Alimenti/Food			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Azoto totale/Total nitrogen, Proteine (da calcolo)/Proteins (calculation)	ISO 1871:2009	Titrimetria	
Ceneri/Ash	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77	Gravimetria	
Sostanze grasse totali/Total fatty substances	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 41 Met A	Gravimetria	
Umidità/Moisture	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 Met B	Gravimetria	
Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value ()	Reg UE 1169/2011 25/10/2011	Calcolo	
Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) ()	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	Calcolo	

Tutti i parametri coinvolti in un calcolo devono essere accreditati perché il calcolo si possa definire accreditato.

ACCREDIA

10

10

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Campo di misura

Il campo di misura è un campo libero presente in tutte le righe dell'Atlante:

- nel caso il laboratorio copra tutto il campo di misura della norma, tale campo non deve essere compilato;
- nel caso sia diverso (limitato o **esteso**⁴) rispetto a quanto indicato nella norma, la compilazione è obbligatoria e non devono essere inserite ulteriori informazioni (es. parametri non previsti, tecniche...);
- nel caso la norma non specifichi un campo di misura, è opportuno, per una maggior chiarezza, indicarlo coerentemente con le verifiche/validazioni effettuate

⁴ Si veda RT-08 per impiego dei metodi fuori dal campo di misura

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Riferimenti normativi

In Atlante non sono presenti norme contenenti solo indicazioni generali o linee guida (es. IEC 60068-1 per gli environmental tests oppure ISO 16474-1 per i test di invecchiamento da esposizione luminosa, ISO 7218 per le analisi microbiologiche), né metodi che non abbiano completato il processo di approvazione e siano stati pubblicati⁵

⁵ Pertanto non sono inseriti in Atlante standard in bozza, neppure se pubblicati (es. norme in versione DIS o FDIS)

TMB Resolution 2026 (25) 01

The Technical Management Board, acting upon recommendation from the Technical Committees, approves that accreditation according to Level 3, 4 and 5 standards can only be delivered against a standard that has completed the formal approval process and that has been published; as a consequence it is not allowed to make reference to a draft standard in the NAB's accreditation scope (whether it is published or not, like DIS or FDIS).

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prodotto

In generale, le norme di prodotto vengono inserite in Atlante **associate ai metodi di prova** richiamati all'interno per i singoli test:

- Nel caso in cui la norma di prodotto riporti solo **referimenti datati**, in Atlante sono presenti le combinazioni con i soli metodi di prova con i relativi anni citati
- Nel caso di **referimenti non datati**, in Atlante sono presenti le combinazioni con l'ultima revisione del metodo di prova citato

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 20344:2021, *Personal protective equipment — Test methods for footwear*

ISO 22568-1:2019, *Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components — Part 1: Metallic toecaps*

ISO 22568-2:2019, *Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear component — Part 2: Non-metallic toecaps*

EN 13832-3:2018, *Footwear protecting against chemicals — Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions*

Es. ISO 20345:2011

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prodotto

Alcune norme **invitano** ad utilizzare documenti comunque più recenti

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below.

Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 354:1985, *Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room*.

ISO 354:1985/Amd. 1:—¹⁾, *Annex D: Test specimen mountings for sound absorption tests*.

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prodotto

Solo per specifici casi alcune norme di prodotto, pur richiamando al loro interno altre norme per effettuare i test, possono essere inserite come **norme autonome**, per maggiore chiarezza degli elenchi (es. alcune norme per apparecchiature elettriche). In questi casi il laboratorio **deve** selezionare sia la norma di prodotto che tutte le norme di prova relative ai test (nella revisione richiesta dalla norma di prodotto) che vuole richiedere in accreditamento.

È possibile inserire in Atlante Capitolati di Prova o Specifiche tecniche del costruttore o del cliente (es. Grandi committenti) a patto che queste siano rese disponibili ad ACCREDIA per la valutazione documentale preliminare alla visita.

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme

In Atlante sono presenti norme relative alla Classificazione e all'Applicazione estesa (EXAP). Possono essere richieste dai laboratori, a condizione che siano richiesti in accreditamento o presenti nello scopo di accreditamento **anche** le relative norme di prova per i singoli test richiamate all'interno o comunque necessarie per l'esecuzione della prova.

Componenti dei sistemi di controllo del fumo/Components of smoke control systems

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction	EN 13501-4:2016, UNI EN 13501-4:2016	Prove al fuoco	

IN VIGORE

 **CEI EN 50576**

CEI
NORMA

CLASSIFICAZIONE CEI: 20-127

Cavi elettrici - Applicazioni estese dei risultati di prova per la reazione al fuoco

DATA PUBBLICAZIONE: 2023-05
COMITATO: CT 20
LINGUA: EN

[→ VAI ALLA SCHEDA](#)

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova

Se una prova viene eseguita a fronte di più metodi (es. preparativa, invecchiamento, lettura), in Atlante sono disponibili, nel menù a tendina, tutte le norme necessarie. In ogni caso, nella scelta del Laboratorio deve essere sempre presente **almeno** una norma di lettura in ciascuna riga selezionata. La matrice riportata è generalmente quella della prima metodica (es. quella della preparativa) o comunque quella più restrittiva/opportuna tra i vari metodi (es. norma di prodotto).

Non è possibile richiedere in accreditamento metodi ufficiali o normalizzati, ciascuno eseguito solo per alcuni fasi o parti. Se necessaria per l'analisi (es particolare matrice), la/le preparative citate devono essere richieste in accreditamento.

Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Terreni (1)/Soils (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Litio/Lithium, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Titanio/Titanium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc	EPA 3050B 1996, EPA 3052 1996, EPA 6010D 2018	ICP-OES	

1.6 Prior to employing this method, analysts are advised to consult the preparatory method for each type of procedure that may be employed in the overall analysis (e.g., Methods 3005, 3010, 3015, 3031, 3040, 3050, 3051, 3052, 7000, and 6800) for additional information on

Alimenti/Food - solo/only Alimenti di origine animale

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	ICP-MS	

ACCREDIA

17

17

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: conferme

Nel caso in cui un metodo preveda delle conferme senza descriverle ma rimandando a uno specifico metodo di prova normalizzato o lasciando al Laboratorio una scelta più ampia (es. metodo ISO, metodo rapido validato, un terreno alternativo o un'altra tecnica) il Laboratorio **deve richiedere l'accREDITAMENTO anche** per l'esecuzione della prova secondo tale metodo, scegliendo tra le opzioni dell'Atlante.

Esclusione conferme: si veda RT-08 par 5.3

Fanno eccezione le fasi di conferma che richiedono prove su animali da Laboratorio o che, secondo disposizioni, devono essere effettuate presso laboratori/centri di riferimento nazionali o comunitari o da centri di riferimento nazionali.

ACCREDIA

18

18

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Campionamento

Nel caso in cui il metodo di prova contenga anche indicazioni per il campionamento, possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. Nel metodo sono descritti **sia il campionamento che l'esecuzione** della prova:

- è censito sia il metodo completo (campionamento+prova) applicato alla matrice prevista dal metodo stesso,
- sia il metodo con l'esclusione del campionamento

Aria di ambienti di lavoro, Aria di ambienti di vita	Amianto	Fibre aerodisperse di Amianto	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B	
Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro, Amianto		Fibre aerodisperse di Amianto	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B (escl campionamento/except sampling)	

Se il laboratorio richiede in accreditamento la norma completa, non deve scegliere anche la norma con l'esclusione. Se saltuariamente non effettua il campionamento basterà indicare sui RdP la matrice analizzata (es supporto) e l'esclusione effettuata (RT-08 cap 7.3.1).

Pertanto, se il laboratorio non vuole richiedere in accreditamento il campionamento, deve selezionare in Atlante la prova dove è esplicitata tale esclusione

ACCREDIA

19

19

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Campionamento

2. Nel metodo è descritta **la sola esecuzione della prova**, mentre per il campionamento si rimanda a un altro metodo.

In Atlante sono censiti in maniera indipendente il metodo di campionamento e il metodo di prova, ciascuno riferito alla relativa norma.

Supporti da campionamento aria sorgenti PCB	(PCB 101) 2-2-4-5-5-pentadibenzofenile, (PCB 105) 2-3-3-4-4-pentadibenzofenile, (PCB UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-4:2014/EC1:2014	analisi
Emissioni da sorgente fissa	Campionamento per PCB diossina simili, Campionamento per PCDD/PCDF	UNI EN 1948-1:2006

Se il laboratorio non vuole richiedere in accreditamento il campionamento, deve selezionare il solo metodo di prova, senza indicare esclusioni.

Se invece intende accreditare anche il campionamento, deve richiederlo in accreditamento separatamente, selezionandolo in Atlante.

ACCREDIA

20

20

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Campionamento

I metodi relativi **solo ad attività** di campionamento sono inseriti in Atlante su righe specifiche e identificati nel campo “tipologia di prova” come “campionamento” in cat III.

Per il campionamento, la matrice indicata in Atlante è quella riportata nel campo di applicazione del metodo

N.	CAT.	MATERIALE / PRODOTTO / MATRICE	MISURANDO / PROPRIETÀ MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO DI PROVA	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA
III		Aria di camere bianche ed ambienti controllati associati/Air of cleanrooms and associated controlled environments	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	UNI EN 17141:2021 Annex E	-	
III		Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcases (Samples from sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 17604:2015	-	
III		Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions	Campionamento per PCB diossina simili/Sampling for PCB dioxin like, Campionamento per PCDD/PCDF/Sampling for PCDD/PCDF	UNI EN 1448-1:2006	-	
III		Superfici ambientali del settore alimentare (Supporti da campionamento superficiali)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	-	
III		Superfici di camere bianche ed ambienti controllati associati/Surface of cleanrooms and associated controlled environments	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	UNI EN 17141:2021 Annex E	-	

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: III			
Aria di camere bianche ed ambienti controllati associati/Air of cleanrooms and associated controlled environments			
Denominazione della prova / Campo di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	OGI
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	UNI EN 17141:2021 Annex E	-	
Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcases (Samples from sampling)			
Denominazione della prova / Campo di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	OGI
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 17604:2015	-	
Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions			
Denominazione della prova / Campo di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	OGI
Campionamento per PCB diossina simili/Sampling for PCB dioxin like, Campionamento per PCDD/PCDF/Sampling for PCDD/PCDF	UNI EN 1448-1:2006	-	
Superfici ambientali del settore alimentare (Supporti da campionamento superficiali)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)			
Denominazione della prova / Campo di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	OGI
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	-	
Superfici di camere bianche ed ambienti controllati associati/Surface of cleanrooms and associated controlled environments			
Denominazione della prova / Campo di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	OGI
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	UNI EN 17141:2021 Annex E	-	

In Atlante **non sono previste** combinazioni di metodi di campionamento + metodi di prova. Sui Rapporti di Prova, il laboratorio può associare la norma di campionamento ai successivi metodi di analisi che hanno lo **stesso ambito e campo di applicazione** della norma di campionamento.

ACCREDIA

21

21

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Ritirati

In Atlante le edizioni superate sono identificate con la parola “**Ritirato**”⁶, visibile sul portale e sulla DA-02 All.1 scaricata ma **non** sull'elenco delle prove accreditate.

Vengono mantenuti in Atlante almeno per tre mesi dalla data di ritiro, salvo diverse indicazioni dell'ente emittente o se richiamate da disposizioni cogenti, capitolati della pubblica amministrazione o da norme di prodotto o richiesti da organismi notificati.

⁶ Il Database viene periodicamente aggiornato a cura di ACCREDIA DL. Si precisa tuttavia che non è stato sviluppato come strumento per la verifica dell'aggiornamento dei documenti di origine esterna da parte dei laboratori di prova che sono tenuti ad effettuare gli adeguati controlli sui siti ufficiali degli enti responsabili dell'emissione dei singoli metodi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
UNI EN ISO 9612:2011 Acustica – determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico-progettuale

IN VIGORE

UNI EN ISO 9612:2025

Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodologia

Recepiace [EN ISO 9612:2025](#)

Nel caso in cui un metodo di prova richiami per l'esecuzione di una fase un altro metodo riportando il **riferimento datato**, in Atlante è presente la combinazione con il solo metodo di prova con il relativo anno citato.

Es. UNI 9432:2011 + UNI EN ISO 9612:2011 Ritirato. La versione aggiornata UNI EN 9612:2025 non può inserita in questa combinazione. In questo caso la combinazione rimane valida fino all'aggiornamento della UNI 9432:2011 relativamente al riferimento datato.

ACCREDIA

22

22

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Ritirati

Oltre ai casi sopra indicati, qualora il laboratorio debba richiedere in accreditamento metodi superati (es. Per Autorizzazioni dei clienti che richiamano metodi datati) deve allegare alla domanda di accreditamento anche le evidenze a supporto di tale richiesta (vedere Regolamento RT-08 per i metodi non più in vigore).

Es di Autorizzazione Integrata Ambientale

Parametro	Emissione	Modalità di controllo		Metodi (1)
		Continuo	Discontinuo	
COV	E15	X	-	UNI EN 12619:2002 UNI EN 13526:2002

Emissioni da sorgente fissa	...	Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 13526:2002 Ritirato	an
Emissioni da sorgente fissa	...	Carbonio organico totale (TOC), Carbonio organico totale in forma gassosa (espresso: DIN EN 12619:2013, EN 12619:2013, UNI EN 12619:2002 Ritirato, UNI EN 12619:2013)		

ACCREDIA

23

23

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Tecniche

Ad eccezione di prove del settore fisico-meccanico ed elettrico dove nella stessa riga possono essere presenti diversi test, in Atlante

- È presente una prova per ogni tecnica,
- la tecnica è relativa alla lettura anche a fronte di più possibilità nella preparativa (es. digestione, colorazione, estrazione liquido/liquido ...).
- in alcuni casi si riporta il principio su cui si basa la tecnica di prova e non i singoli strumenti di misura che sono compresi nella dizione più ampia (ad es. HPLC-DAD è compreso in HPLC-UV-VIS).

Alimenti di origine vegetale, Miele, Parti d	Pesticidi	Metil-isotiocianato, (2,4-diclorofenossi)acetate (2-4 D D estere metilic	BS EN 15662:2018, DIN EN 15662:2018, EN 15662:2018, EVS EN 15662:2018, UNI EN 15662:2018
Alimenti di origine vegetale, Miele, Parti d	Pesticidi	Metil-isotiocianato, (2,4-diclorofenossi)acetate (2-4 D D estere metilic	BS EN 15662:2018, DIN EN 15662:2018, EN 15662:2018, EVS EN 15662:2018, UNI EN 15662:2018
Alimenti di origine vegetale	Pesticidi	Aldrina, Chlortrina - lambda, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Diel	UNI EN 15662:2018
Alimenti di origine vegetale, Miele, Parti d	Pesticidi	Metil-isotiocianato, 1-(3-4-Diclorofenil)-3-metilurea, 1-(3-4-Diclorofenil)-3-metilurea	EN 15662:2018, UNI EN 15662:2018

GC-MS/MS

LC-MS/MS

GC-ECD

GC-MS

ACCREDIA

24

24

Metodi di prova normalizzati, non normalizzati, ufficiali

Norme di prova: Tecniche

Si ricorda che nel caso di tecniche di prova non previste dai metodi, cambio del rivelatore o del terreno di coltura, non è possibile mantenere il riferimento al metodo ufficiale/normalizzato/non normalizzato, ma è necessaria la trasformazione in metodo sviluppato dal laboratorio (vedere Regolamento ACCREDIA RT-08).



Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Materiale/Prodotto/Matrice

Si ricorda la Circolare DL n° 1/2026 in merito alle matrici per i Metodi sviluppati dal laboratorio (metodi interni) <https://www.accredia.it/documenti/circolare-informativa-dl-n-01-2026-aggiornamento-del-portale-da-online/>

"... alla prima occasione utile..."



- per i laboratori di Prova:

- l'inserimento di un controllo sulle tecniche di prove dei metodi normati e relativa segnalazione;
- il miglioramento di alcuni messaggi per la segnalazione di errori al fine di rendere più chiare le operazioni da svolgere nel portale;
- l'eliminazione dall'Atlante di termini duplicati e allineamento della terminologia, in particolare per i parametri chimici;
- la segnalazione di errori relativi a "prove/metodi sviluppati dal laboratorio" con matrici e/o parametri eccessivamente generici;
- la revisione dei menù a tendina per le prove flessibili da cui scegliere matrici e parametri mantenendo i soli termini consentiti dal regolamento RT-26.

Per i laboratori che devono effettuare correzioni e/o integrazioni per i metodi interni sono visibili nel proprio elenco online le relative segnalazioni di modifiche.

Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Materiale/Prodotto/Matrice

È disponibile in Atlante un elenco di “Materiale/Prodotto/Matrice” tra cui scegliere. Il laboratorio può chiedere di implementare l’elenco con nuovi termini ma non con sinonimi.

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alaclor/Alachlor, Boscalid/Boscalid, Ciproconazolo/Cyproconazole, Metalaxil/Metalaxyl, Metolachlor/Metolachlor, Pirimicarb/Pirimicarb, Prometon/Prometon, Tebuconazolo/Tebuconazole, Terbutilazina/Terbuthylazine, Triadimefon/Triadimefon (10 - 250 ng/Kg)	MI 000 Rev. 0 2026	GC-MS/MS	

Supporti da campionamento superficiali di camere bianche ed ambienti controllati associati/Samples from surface of cleanrooms and associated controlled environments			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Clostridium difficile/Clostridium difficile (> 1 UFC su sponge)	MI 000 Rev. 0 2026	Esame visivo	

Il Laboratorio deve selezionare, nel campo “Materiale/Prodotto/Matrice”, solo le specifiche matrici per cui ha effettuato la validazione ed è quindi in possesso dei relativi dati, senza indicare matrici troppo generiche che potrebbero comportare una flessibilità.

ACCREDIA

27

27

Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Materiale/Prodotto/Matrice

Se un metodo sviluppato dal laboratorio prevede l’applicazione per più macromatrici (es. suoli, acque e alimenti) il laboratorio deve inserire una riga per ciascuna tipologia di matrice.

Liquidi biologici animali/Animal biological liquids, Organi animali/Animal organs, Uova non schiuse/Unhatched			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Salmonella spp/Salmonella spp ()	MI 123 Rev. 0 2026	Metodo culturale - ricerca	

Alimenti/Food, Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage, Feci animali/Animal faeces, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento superficiali ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Salmonella spp/Salmonella spp	MI 123 Rev. 0 2026	Metodo culturale - ricerca	

ACCREDIA

28

28

Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della prova

È disponibile in Atlante un elenco di “Misurando/proprietà misurata/denominazione della prova” tra cui scegliere. Il laboratorio può chiedere di implementare l'elenco con nuovi termini ma non con sinonimi.

Integratori alimentari per uso umano/Food supplements for human consumption			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	
Fenilalanina/Phenylalanine, Isoleucina/Isoleucine, Istidina/Histidine, Leucina/Leucine, Lisina/Lysine, Metionina/Methionine, Treonina/Threonine, Triptofano/Tryptophane, Valina/Valine (≥100 mg/kg o mg/L, ≥0,01 g/100g, g/100mL)	MI 000 Rev. 0 2026	HPLC-UV-vis	
Alimenti/Food, Integratori e premiscelate/Supplements and premixes, Mangimi/Animal feeding stuffs			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Amminoacidi/Amino acids	MI 000 Rev. 0 2026	HPLC-MS	

Nel compilare il misurando, il Laboratorio non può scegliere categorie generiche (es “Metalli”, termine dedicato alle prove flessibili) ma i singoli analiti/grandezze per cui il Laboratorio stesso ha effettuato la validazione ed è quindi in possesso dei relativi dati (es. Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo, Potassio, Vanadio, Zinco).

ACCREDIA

29

29

Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Campo di misura

Il campo di misura è un campo libero presente in tutte le righe.

La compilazione da parte del Laboratorio è obbligatoria (es. range, limite di determinazione, presenza/assenza, rilevabile/non rilevabile, passa/non passa, ecc.).

Detersivi per lavaggio manuale delle stoviglie/Detergents for manual washing of dishes			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Efficacia di lavaggio/Cleaning effectiveness (Passa/non passa (test ANOVA))	MI 000 Rev. 0 2026	Esame visivo	
Tensioattivi cationici/Cationic surfactants (0.2mg/l – 2.0 mg/l)	MI 100 Rev. 0 2026	Spettrofotometria UV-VIS	
Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants (LOQ 0,2 mg/l)	MI 110 Rev. 0 2026	Spettrofotometria UV-VIS	
Campioni ambientali/Environmental samples, Tessuti animali/Animal tissues			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Salmonella spp/Salmonella spp (RILEVATA/NON RILEVATA)	MI 357 Rev. 0 2026	Metodo culturale - ricerca	

Non devono essere inserite ulteriori informazioni (es. parametri non selezionabili, tecniche...).

ACCREDIA

30

30

Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Metodo di prova

I metodi sviluppati dal laboratorio vanno identificati con:

- codice e/o sigla alfanumerica definita dal Laboratorio
- indice di revisione
- anno di revisione

Il laboratorio non deve utilizzare acronimi, sigle o codici che possano generare confusione o sovrapposizione con metodi ufficiali/normalizzati.

Solo nel caso in cui il metodo sviluppato dal laboratorio sia stato redatto per integrare un metodo normato non esaustivo, è possibile riportare la combinazione del metodo normato e del metodo sviluppato dal Laboratorio (RT-08). In tutti gli altri casi il metodo sviluppato dal laboratorio deve essere completo e autoportante, quindi **non sono previste** altre possibili combinazioni (metodo interno + metodo interno).

ACCREDIA

31

31

Metodi di prova sviluppati dal laboratorio

Tecnica

Per ciascun metodo sviluppato dal laboratorio richiesto in accreditamento, il laboratorio deve selezionare la tecnica di prova, scegliendo tra quelle disponibili in Atlante.

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters			
Pesticidi/Pesticides : 2,4-N-dimetilfenil-formammide/N-(2,4-dimethyl-phenyl)-formamide, Acetamiprid/Acetamiprid, Acetoclor/Acetochlor, Alaclor/Alaclor, Ametrina/Ametrine, Ancyrida/Ancyrida, Atrazina/Atrazine, Azacozolo/Azacozolo, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Azossistrobina/Azoxystrobin, Benalaxil/Benalaxyl, Bendiocarb/Bendiocarb, Bensulfuron metile/Bensulfuron methyl, Boscalid/Boscalid, Bromuconazolo/Bromuconazole, Carbanil/Carbanil, Carbetamide/Carbetamide, Cianazina/Cyanazine, Ciantranilprole/Cyantranilprole, Cimoxanil/Cimoxanil, Ciproconazolo/Cyproconazole, Cloranttrilprole/Chlorantranilprole, Clorotoluron/Chlorotoluron, Cycluron/Cycluron, Demeton-S-metil	MI 000 rev. 0 2026	LC-MS/MS	
Pesticidi/Pesticides : Acido 1-naftilacetico (NAA)/1-naphthylacetic acid (NAA), Aclonifen/Aclonifen, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Beflubutamid/Beflubutamid, Benfuril/Benfuril, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Bromacil/Bromacil, Bromofos-etile/Bromophos-ethyl, Bromofos-metile/Bromophos-methyl, Bupirimate/Bupirimate, Carbofenotio/Carbophenothion, Chinometionato/Chinomethionat, Clordano (cis)/Chlordane (cis), Clordano (trans)/Chlordane (trans), Clordecone/Chlordecone (Kepone), Clorfenapir/Chlorfenapyr, Clorfenson/Chlorfenson, Clorfeninfos/Chlorfeninfos, Clorobenzilato/Chlorobenzilate, Cloropropilato/Chloropropylate, Clorpirfos etile/Chlorpyrifos-Ethyl, Clorpirfos metile/Chlorpyrifos methyl, Clorifos/Chlorthiophos, Clorzinato/Chlorzinolate,	MI 000 rev. 0 2026	GC-MS/MS	

ACCREDIA

32

32

FLESSIBILE: Prova madre e di dettaglio

Materiale/Prodotto/Matrice e Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della Prova

In caso di accreditamento flessibile, ciascuna prova (cd "prova madre") deve essere inserita in elenco prove tramite il portale DAonline seguendo quanto di seguito:

- È necessario rimanere all'interno della flessibilità richiesta dal laboratorio, coerentemente con lo scopo fisso il laboratorio può selezionare anche matrici e parametri più ampi (es. Acque/Metalli; Materiali metallici/Durezza).
- In caso di matrici afferenti a macromatrici diverse è necessario inserire una riga per ciascuna macromatrice (es. Acque e Urine vanno inserite su due righe differenti).
- Parametri troppo ampi (es. contaminati, parametri chimici, microrganismi, analisi chimica) non possono essere inseriti. Devono essere specificate "famiglie" di analiti con caratteristiche chimiche simili (come ad esempio PCB, pesticidi clorurati, IPA, PFAS ecc.). Inoltre, classi di parametri diverse vanno su righe diverse (es. allergeni e OGM; pesticidi e PCB).

ACCREDIA

33

33

FLESSIBILE: Prova madre

Tecnica e metodo

- Il laboratorio deve scegliere una tecnica di prova per ciascuna riga specificando anche il rivelatore (es. HPLC-MS, HPLC-FLD).

Non è possibile inserire prove che prevedono la tecnica "Metodo colturale", neanche se seguita da altra tecnica di conferma (es. Metodo colturale + PCR). (Circolare n°3/2023)

Dagli esiti delle valutazioni condotte, e riprendendo quanto già previsto dal Regolamento RT-26 "Prescrizioni per l'accreditamento con campo di accreditamento flessibile - laboratori di prova, laboratori medici, laboratori di taratura, organizzatori di prove valutative interlaboratorio (PTP)" rev. 07, si chiarisce che, per le prove microbiologiche:

- a) i **metodi automatizzati che non prevedono conferme** possono rientrare nell'accreditamento con campo flessibile;
- b) i **metodi automatizzati che richiedono la conferma con altri metodi automatizzati senza passaggi culturali** che prevedono identificazione e riconoscimento possono rientrare nell'accreditamento con campo flessibile;
- c) i **metodi automatizzati che prevedono una conferma attraverso passaggi culturali** e di identificazione e riconoscimento (di qualsiasi tipo essa sia) non possono rientrare nell'accreditamento con campo flessibile;

Per le righe per cui non è possibile individuare una tecnica specifica è necessario inserire il dettaglio della norma di riferimento nel campo di misura (es. IEC 60335-1 che sottintende che le tecniche incluse sono solo quelle previste dalla norma di riferimento indicata).

ACCREDIA

34

34

FLESSIBILE: Prova madre

Tecnica e metodo

In caso di prima richiesta di prova flessibile nel campo "metodo di prova" il laboratorio deve indicare, anche in maniera semplificata, tutti i metodi che intende passare dal campo fisso.

Prove da Accreditare Prova da metodo flessibile

Settore * Macromatrice *

Materiale/Prodotto/Matrice

può essere analogo a quello del campo di accreditamento fisso ma anche generico (es Acque)

Metodo

Elencare tutti i metodi di accreditamento che il CAB ha già accreditato con campo fisso da almeno 2 anni

EPA 6010, ISO 11885...

ACCREDIA

35

35


Il piano di transizione

Beatrice Bargellini

Responsabile sistema di gestione ACCREDIA

36

RT-23 rev.05 – piano di transizione

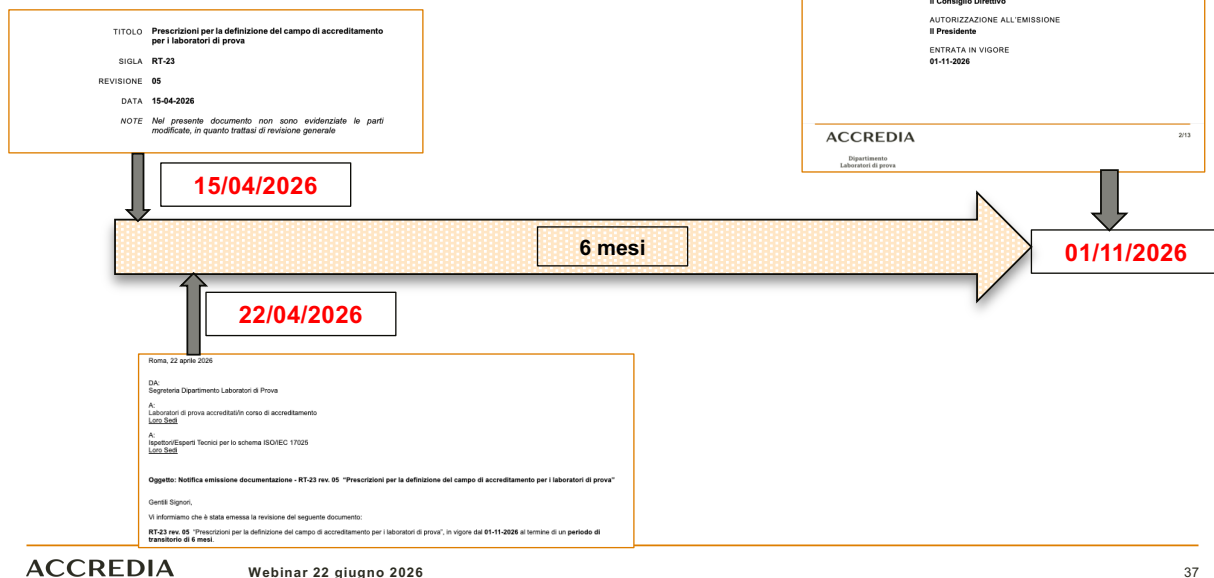

37

RT-23 rev.05 – piano di transizione

Nella notifica del 22/04/2026 è stato specificato:

- transitorio 6 mesi
- aggiornamento dello scopo, non limitandolo alle sole prescrizioni per i laboratori di prova, ma introducendo i criteri per la compilazione e l'implementazione dell'Atlante da parte di Accredia;
- campo di applicazione, ridotto ai soli laboratori di prova, in quanto, per i laboratori medici, è utilizzato un modulo xls precompilato con le descrizioni del campo di accreditamento;
- struttura del documento completamente riorganizzata, allineandola ai termini dell'Atlante senza tuttavia alterare i principi delle precedenti revisioni che, peraltro, sono stati utilizzati come riferimento per la definizione dell'Atlante e la gestione del transitorio.

TITOLO Prescrizioni per la definizione del campo di accreditamento per i laboratori di prova
SIGLA RT-23
REVISIONE 05
DATA 15-04-2026
NOTE Nel presente documento non sono evidenziate le parti modificate, in quanto trattasi di revisione generale

REDAZIONE
Il Direttore del dipartimento laboratori di prova
APPROVAZIONE
Il Consiglio Direttivo
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Presidente
ENTRATA IN VIGORE
01-11-2026

ACCREDIA
Dipartimento
Laboratori di prova

ACCREDIA

Webinar 22 giugno 2026

38

38

RT-23 rev.05 – transitorio per adeguamento elenchi prove

Il transitorio riguarda:

ACCREDIA:

- inserimento nuove prove in Atlante (non precedentemente censite, ad es. metodi richiamati da altri metodi, nel caso sia diventato obbligatorio esplicitarli)
- adeguamento/aggiornamento indicazione di alcune prove (es. calcoli)

I LABORATORI:

- richiedere in accreditamento nuove prove (ad es. metodi richiamati da altri metodi, nel caso sia diventato obbligatorio esplicitarli)
- adeguamento/aggiornamento degli elenchi prove (laboratori già accreditati), a seguito dell'aggiornamento dell'Atlante (es. calcoli)

RT-23 rev.05 – transitorio per adeguamento Atlante

ACCREDIA

- entrata in vigore RT-23 rev.05: ➡ **1 novembre 2026**
- aggiornamento Atlante per inserimento nuovi metodi (es. metodi richiamati nel caso sia diventato obbligatorio esplicitarli): ➡ **immediata**, dalla richiesta dei laboratori
- aggiornamento Atlante per modifiche prove (es. calcoli) ➡ **1 novembre 2026**



- i nuovi laboratori che entrano dal 1 novembre 2026, trovano l'Atlante già aggiornato e possono scegliere solo le prove presenti
- per i laboratori già accreditati, dopo il 1 novembre troveranno un messaggio di errore per le prove aggiornate → devono aggiornare l'elenco prove secondo un **piano di transizione specifico**

RT-23 rev.05 – transitorio adeguamento elenchi prove

LABORATORI GIÀ
ACCREDITATI

30 aprile 2027



DEADLINE PER TUTTI I LABORATORI:

- tutti i laboratori devono prendere in carico le modifiche
- scaricare il file xls DA02All1
- inviarlo ad ACCREDIA

30 giugno 2027



DEADLINE PER ACCREDIA:

- verifica degli elenchi (verifica ispp. con MD-08-13/RED)
- inserimento in Atlante di nuovi metodi non censiti (in particolare per prove di prodotto, elettriche, ...)

ATTENZIONE



Soprattutto per i laboratori che devono accreditare anche le altre prove (es. nei calcoli e nelle norme di prodotto)

ACCREDIA

Webinar 22 giugno 2026

41

41

RT-23 rev.05 – transitorio per adeguamento elenchi prove

AGGIORNAMENTO ELENCHI PROVE

NEL CASO DI SOLA VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO A RT-23 rev.05

- gestita come variazione
- nella DA02All1 xls scaricata da DAonLine le prove modificate/aggiunte per adeguamento sono identificate con E in automatico, ma nel database interno vengono gestite come variazione.
- non richiesto pagamento quota estensione
- non necessario trasmettere dati prestazionali (perché anche se non esplicitate, eventuali prove richiamate erano comunque oggetto di verifica quando campionata la prova principale)

NEL CASO DI VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO A RT-23 rev.05 CONTESTUALE A SORVEGLIANZA o S+E

- la gestione è la medesima,
- ma la modifica viene gestita contestualmente al processo in corso (S, S+E)
- nel caso di estensione diversa dall'adeguamento RT-23 (prove ulteriori rispetto alla sola modifica), è prevista la quota di estensione come da Tariffario

ACCREDIA

Webinar 22 giugno 2026

42

42

Risposte alle domande poste durante il webinar

43

Categoria di prova

D: Se una prova viene eseguita in più di una categoria come deve essere caricata in DAonline?

R: In caso una prova sia associata a più di una categoria sarà necessario inserire una riga per ciascuna delle categorie coinvolte.

Solo per la Cat.I è necessario compilare un elenco prove per la sede temporanea.

N	Acque destinate al consumo umano (1), Acque naturali	Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	0
N	Acque destinate al consumo umano (1), Acque naturali	Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	III

ACCREDIA

44

44

Esclusioni di fasi di prova

D: A fronte dell'accreditamento per la matrice alimenti, nel caso in cui il cliente effettui la fase di estrazione del DNA, la matrice DNA estratto da alimento è compresa o deve essere selezionata in elenco prove?

R: La matrice DNA estratto da alimento è compresa, non deve quindi essere aggiunta in elenco prove. Deve essere selezionata solo dai laboratori che hanno escluso a priori la fase di estrazione del DNA.

D: È possibile escludere la fase preparativa da un metodo normato che la prevede al suo interno, demandandola al cliente?

R: Se la preparativa è sempre esclusa il laboratorio può indicare l'esclusione del capitolo relativo nel campo del metodo di prova, purché tale esclusione non snaturi il metodo (vedi RT-08 par. 7.2.1.1).

ACCREDIA

45

45

Consultazione e modifiche Atlante

D: È possibile accedere alla DAonline per la consultazione dell'Atlante prove con l'elenco bloccato?

R: Attualmente non è possibile.

D: È prevista in futuro la possibilità di bloccare l'accesso senza scaricare un file da inviare per mail?

R: L'implementazione di questa modifica è in corso di valutazione.

D: È possibile ricevere comunicazioni di variazioni di parametri e matrici con la data di implementazione con una certa periodicità?

R: Attualmente è possibile consultare la sezione News dove vengono inserite le variazioni dell'Atlante più significative e che possono avere impatto sugli elenchi prove.

ACCREDIA

46

46

Calcoli

D: Le righe relative ai calcoli come idrocarburi totali, tensioattivi totali, dose totale indicativa, rapporti tra grandezze verranno eliminati dall'Atlante?

R: Entro novembre verranno completate tutte le modifiche necessarie nell'Atlante che saranno visibili al laboratorio al primo accesso al portale.

D: Parametri per calcolo. Se non è indicato nel metodo di prova occorre che nelle istruzioni di dettaglio emesse dal laboratorio sia indicato come effettuare il calcolo?

R: Sì. Si veda il requisito 7.2.1.3 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 40

ACCREDIA

47

47

Campo Esclusione/Solamente

D: A fronte di un metodo di prova che descrive al suo interno più metodiche alternative è possibile esplicitare le esclusioni?

R: Sì, se il laboratorio non intende accreditare tutti i metodi alternativi descritti può inserire l'esclusione nell'apposito campo in riferimento al metodo di prova. Se il campo non risulta attivo si può richiedere l'attivazione all'indirizzo aiutodaonline@accredia.it. Se si tratta di tecniche di prova diverse basta caricare solo la riga/righe di interesse senza inserire dettagli di esclusioni.

D: Se nel capitolo relativo al campionamento è presente un rimando ad altro metodo e non è descritta l'attività da eseguire, è necessario indicare l'esclusione sull'elenco prove?

R: No, in questo caso non deve essere inserita nessuna esclusione. Il laboratorio risulterà accreditato per il campionamento solo se ha il metodo di campionamento citato selezionato su riga a parte.

D: Se una prova normata è attualmente censita per "Alimenti", con le variazioni del portale sarà eliminata e sostituita con altre più specifiche o vale solo per i metodi interni?

R: No, in questo caso rimarrà la matrice Alimenti come da campo di applicazione del metodo. Non è necessario in questi casi specificare le esclusioni o le singole matrici verificate. Se il laboratorio decide di ridurre il campo di applicazione, deve specificarlo in maniera dettagliata.

ACCREDIA

48

48

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it



Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteriaadt@accredia.it

accredia.it

f in   